


可溶性免疫チェックポイント分子の 測定研究受託サービスを始めました！

血中の可溶性免疫
チェックポイント分子を自動で迅速かつ
高感度に測定します。


3種類のバイオマーカー
(sPD-1、sPD-L1、sCTLA-4*)から
ご希望の測定項目をお選び頂けます。

検体を送付頂くだけで、
測定は弊社で行い、
測定結果をご報告致します。

*soluble form (可溶性分子)




癌細胞による免疫チェックポイント分子を介した不活性化経路

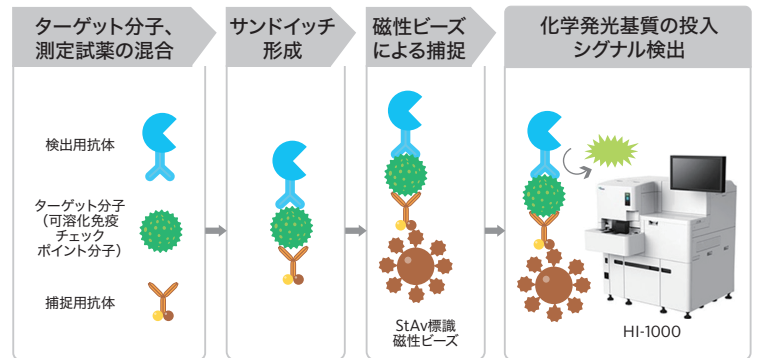

可溶性免疫チェックポイント分子の測定の流れ

測定項目	最小検出感度	測定範囲
sPD-1	2 pg/mL	4-8,000 pg/mL
sPD-L1	3 pg/mL	8-18,000 pg/mL
sCTLA-4	0.1 pg/mL	0.3-1,200.0 pg/mL

可溶性免疫チェックポイント分子の分析性能

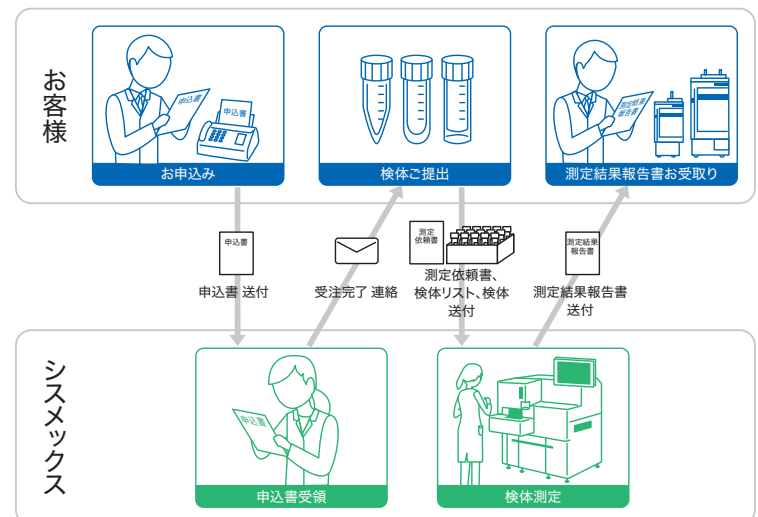

測定研究受託サービスの流れ

本サービスは研究用のため、診断には使用できません。

製造販売元

シスメックス株式会社

お問い合わせ先

クリニカルイノベーション本部

神戸市西区高塚台4-4-4 〒651-2271 Tel 078-991-2147 Fax 078-992-3284

<http://lifescience.sysmex.co.jp>